
CT7 : ATTELLE DE TRACTION FEMORALE ADULTE/ENFANT

Descriptif du dispositif

1- Sections de tubes en carbone reliées entre elles par un dispositif élastique permettant de déterminer la taille optimale pour l'immobilisation du membre.
2- Sangle ischiatique placée au niveau de l'aine et du grand trochanter
3- Sangle de cheville
4- Ecrou hexagonal sur la partie distale du tube et relié à la sangle de cheville.

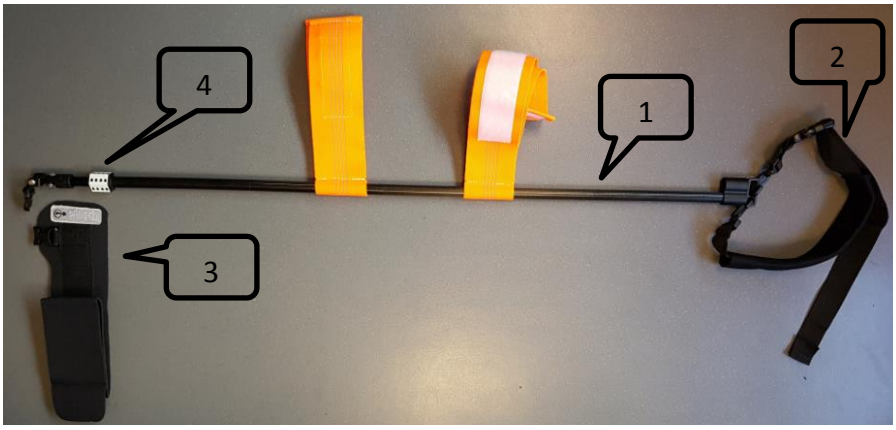

Indication

Immobilisation en traction d'une fracture du fémur après réduction et analgésie.


Mode d'emploi

1-Assemblage de l'attelle de haut en bas en connectant les sections de tube.

-Prendre la sangle de cheville (située dans la poche avant du sac de transport).

2-Mesure de la longueur d'attelle à déployer

- Placer le haut de l'attelle (avec la sangle ischiatique) au sommet de la hanche du patient.
- Le bas de l'attelle devra être positionné à la hauteur de la cheville du patient.

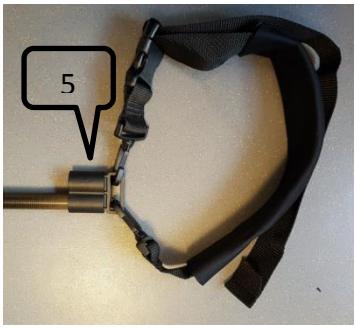

3- Ajustement de la longueur

- Pliez les sections de tube non nécessaires sur le côté pour obtenir une dimension correcte.
- Bloquer la longueur de l'attelle avec le système de détrompeur (5) intégré au capuchon.

4- Positionnement de la sangle de cheville




- Placer la sangle de cheville autour de la cheville.
- S'assurer que la boucle est positionnée côté plante de pied au niveau de la malléole externe.
- Enrouler autour de la cheville la longueur restante



5- Positionnement de la sangle ischiatique

- Placer la sangle ischiatique autour du haut de la jambe et attacher la boucle.
- Ajuster la sangle
- Prévenir les compressions et pincements de la zone urogénitale.

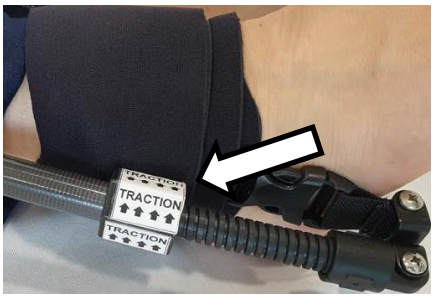

6- Traction

- Tourner l'écrou hexagonal dans le sens des flèches indiquées.
- Sa conception permet un blocage instantané quand la traction souhaitée est atteinte.

7- Stabilisation de l'attelle

- Positionner les sangles : au-dessus du genou et en dessous. Ne pas couvrir les blessures ni le genou.
- Vérifier la traction, réajuster au besoin. L'écrou hexagonal n'a pas besoin de blocage complémentaire.




Nettoyage

Nettoyage de surface à l'eau et au savon puis désinfection et séchage avant reconditionnement.

CT7 : ATTELLE DE TRACTION FEMORALE ADULTE/ENFANT

Descriptif du dispositif

5- Sections de tubes en carbone reliées entre elles par un dispositif élastique permettant de déterminer la taille optimale pour l'immobilisation du membre.
6- Sangle ischiatique placée au niveau de l'aine et du grand trochanter
7- Sangle de cheville
8- Ecrou hexagonal sur la partie distale du tube et relié à la sangle de cheville.

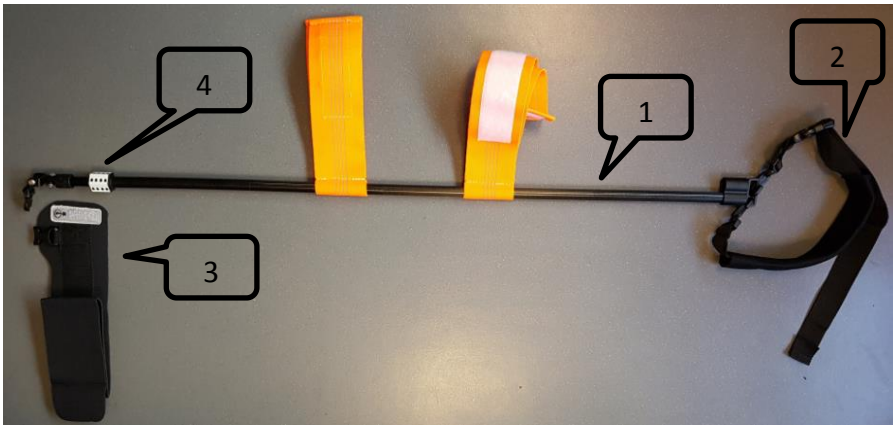

Indication

Immobilisation en traction d'une fracture du fémur après réduction et analgésie.


Mode d'emploi

1-<u>Assemblage de l'attelle</u> de haut en bas en connectant les sections de tube.

-Prendre la sangle de cheville (située dans la poche avant du sac de transport).

2-<u>Mesure de la longueur d'attelle à déployer</u>

- Placer le haut de l'attelle (avec la sangle ischiatique) au sommet de la hanche du patient.
- Le bas de l'attelle devra être positionné à la hauteur de la cheville du patient.

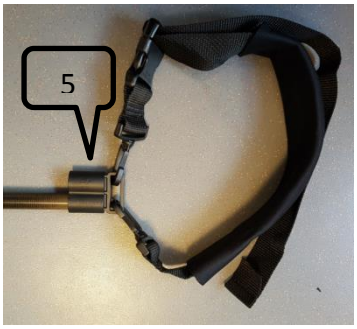

3- <u>Ajustement de la longueur</u>

- Pliez les sections de tube non nécessaires sur le côté pour obtenir une dimension correcte.
- Bloquer la longueur de l'attelle avec le système de détrompeur (5) intégré au capuchon.

4- Positionnement de la sangle de cheville




- Placer la sangle de cheville autour de la cheville.
- S'assurer que la boucle est positionnée côté plante de pied au niveau de la malléole externe.
- Enrouler autour de la cheville la longueur restante



5- Positionnement de la sangle ischiatique

- Placer la sangle ischiatique autour du haut de la jambe et attacher la boucle.
- Ajuster la sangle
- Prévenir les compressions et pincements de la zone urogénitale.

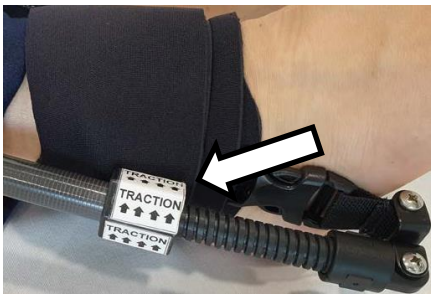

6- Traction

- Tourner l'écrou hexagonal dans le sens des flèches indiquées.
- Sa conception permet un blocage instantané quand la traction souhaitée est atteinte.

7- Stabilisation de l'attelle

- Positionner les sangles : au-dessus du genou et en dessous. Ne pas couvrir les blessures ni le genou.
- Vérifier la traction, réajuster au besoin. L'écrou hexagonal n'a pas besoin de blocage complémentaire.



Nettoyage

Nettoyage de surface à l'eau et au savon puis désinfection et séchage avant reconditionnement.